


全血快速标记流程

※ 所需试剂：荧光抗体、同型对照抗体、红细胞裂解液10X (C03-05002)、0.01M PBS (C01-01001)

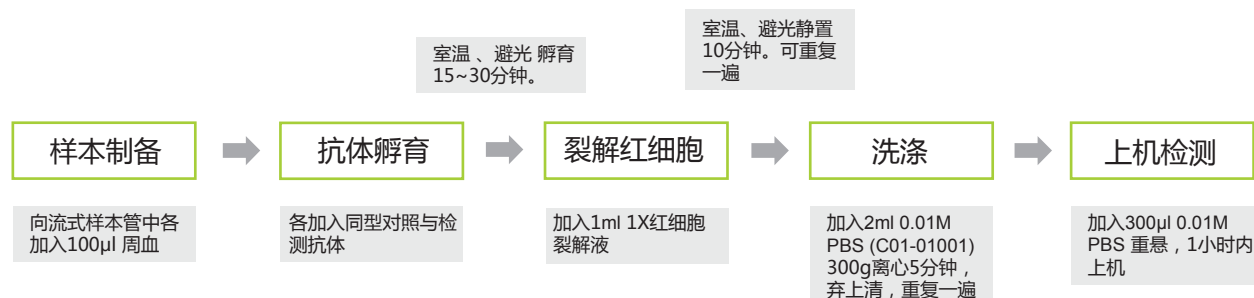


细胞膜表面标记流程——直接标记

※ 所需试剂：荧光抗体、同型对照抗体、0.01M PBS (C01-01001)、封闭液(C01-03001)、抗体标记液(C03-04001)




细胞膜表面标记流程——间接标记

※ 所需试剂：无荧光一抗、荧光二抗、同型对照抗体、0.01M PBS (C01-01001)、封闭液(C01-03001)、抗体标记液(C03-04001)

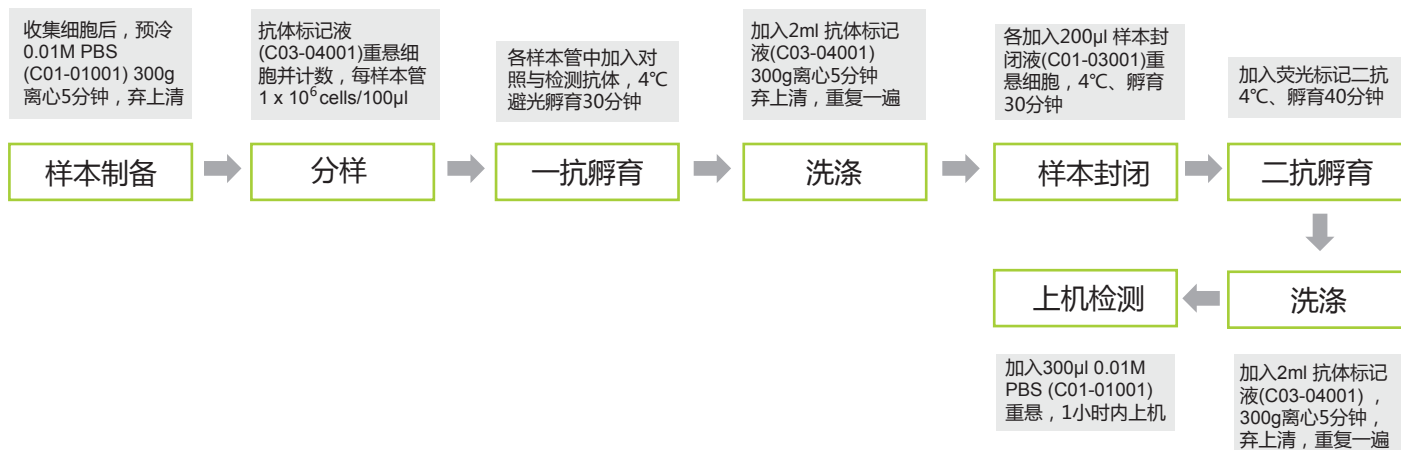

细胞膜内标记流程——直接标记

※ 所需试剂：荧光抗体、同型对照抗体、0.01M PBS (C01-01001)、抗体标记液(C03-04001)
固定液(C01-06002)，穿膜剂(C03-03003) / (C01-01004)

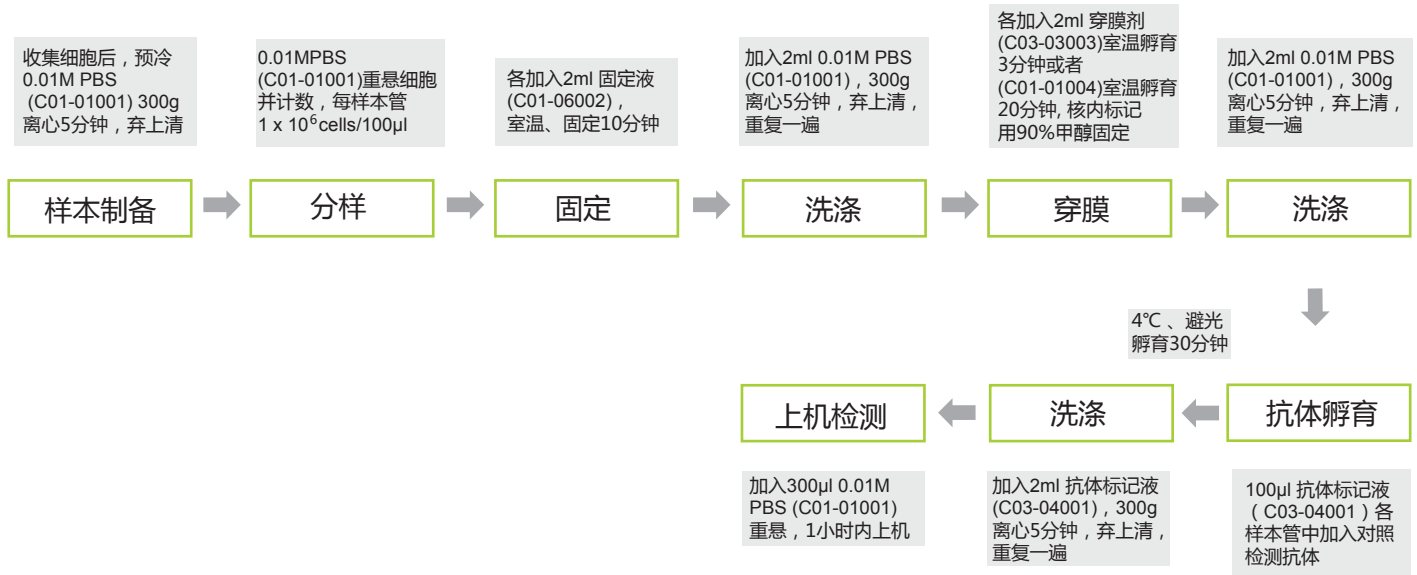

细胞膜内标记流程——间接标记

※ 所需试剂：无荧光一抗、荧光二抗、同型对照抗体、0.01M PBS (C01-01001)、抗体标记液(C03-04001)
固定液(C01-06002)，穿膜剂(C03-03003) / (C01-01004)

